

Guia Rápido de Procedimentos para NÃO-INTENSIVISTAS

O que fazer se o monitor de SatO2 alarmar

QUANDO EXECUTAR

1. Ao ouvir o monitor de SatO2 alarmar

COMO EXECUTAR


- a) Cheque o monitor para ver porque está alarmando
- b) Cheque se o oxímetro está conectado no paciente
- c) Cheque se a fonte de oxigênio está ligada
- d) Cheque se o paciente está conectado ao respirador
- e) Cheque se o respirador também está alarmando



- a) Cheque se o tubo orotraqueal está na posição correta
- b) Cheque o nível de oxigênio que o paciente está recebendo
- c) Cheque se precisa aumentar o fornecimento de oxigênio
- d) Obtenha uma gasometria arterial



- a) Cheque se o paciente precisa de aspiração orotraqueal
- b) Cheque se os dois lados do tórax do paciente se movem igualmente
- c) Cheque se o paciente está tossindo

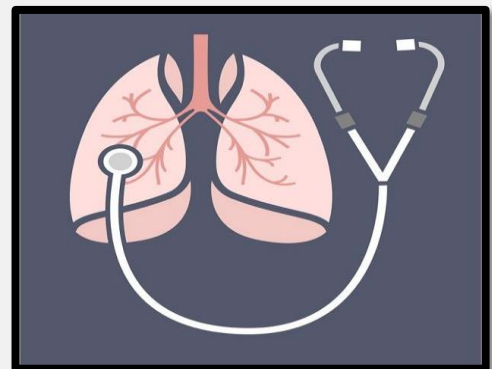

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA/QUANDO CHAMAR AJUDA

1. Se a SatO2 estiver menor que 88%: **chame ajuda**
2. Caso não consiga encontrar uma razão para a queda da SatO2 : **aumente o nível de O2 enquanto aguarda ajuda**
3. Certifique-se que sempre tenha um modo alternativo de ventilar o paciente